


放射線測定設備性能検査申請書

令和元年12月 9日		
原子力規制委員会 殿		
申請者		
住 所 神奈川県横須賀市内川二丁目3番1号		
氏 名 株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン		
代表取締役社長 中島 潤二郎		
放射線測定設備を設置いたしましたので、原子力災害対策特別措置法第11条第5項の規定に基づき申請します。		
原子力事業所の名称及び所在地	株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 神奈川県横須賀市内川二丁目3番1号	
検査を受ける放射線測定設備の数及び概要	設置の数	1式（局舎No. 2のうち、高線量計測系の修理）
	種 類	電離箱
	測定対象	ガンマ線
	計測範囲	10^1 nGy/h～ 10^8 nGy/h
	警報設定点	10^3 nGy/h
	設置位置	事業所区域境界付近（添付図参照）

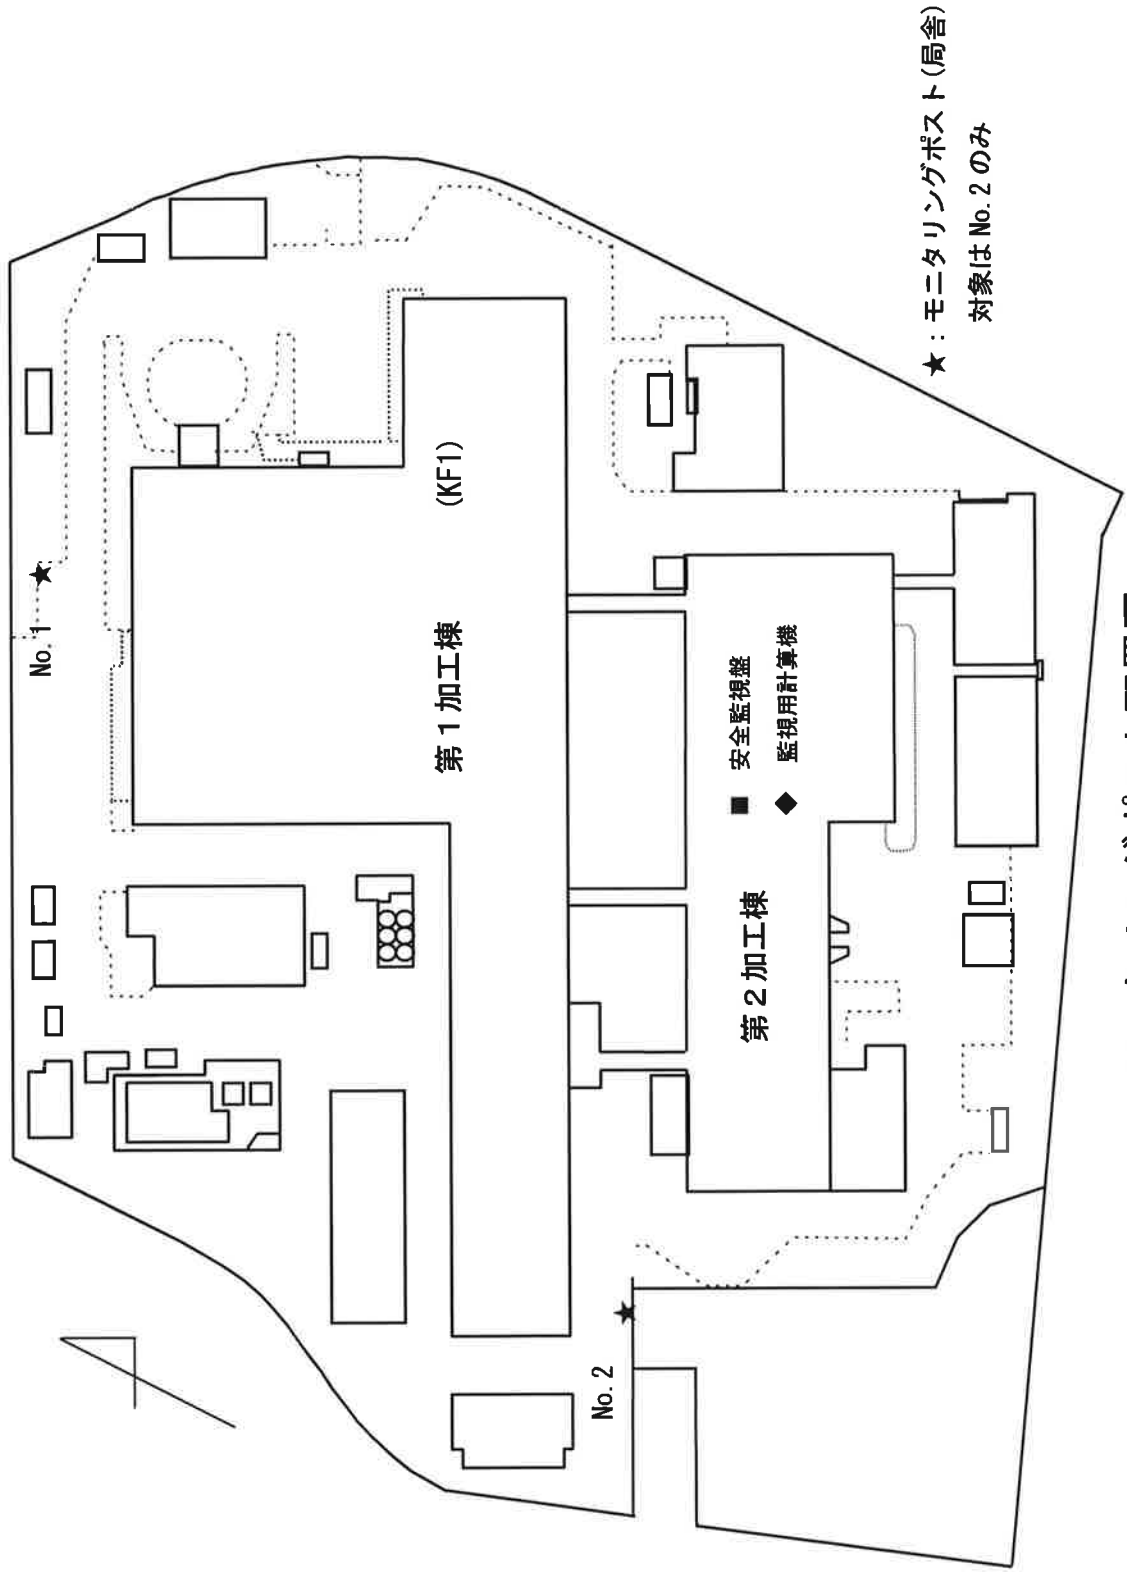

モニタリングポスト配置図